



Alla Ditta:  
**GENERALI ARREDAMENTI S.r.l.**  
 Via Pisa, 8 Loc. Bonelle  
 51100 PISTOIA (PT)  
 generaliarredamenti@officinaspec.it


OGGETTO: Omologazione, ai fini della prevenzione incendi, del prodotto denominato commercialmente: "POLTRONA IREMIA"

Ai sensi di quanto previsto dai DD.MM. 26 giugno 1984 e 3 settembre 2001, si trasmette l'atto di Omologazione, ai fini della prevenzione incendi, relativo al prodotto citato in oggetto.  
 L'atto di Omologazione allegato, ad eccezione dei casi di decadenza e revoca dell'omologazione previsti dall'art. 9, punti 2 e 3, del D.M. 26/06/1984, ha una validità di cinque anni a decorrere dalla data di rilascio e potrà essere rinnovato, alla sua naturale scadenza, sotto l'espressa condizione che il prodotto non abbia subito modifiche rispetto al prototipo sottoposto a prova ed omologato da questo Ministero.

IL DIRIGENTE  
 Mauro PACIOLAI

**L'OMOLOGAZIONE**  
 La poltrona è stata sottoposta ad una serie di prove presso alcune strutture in Italia e all'estero dal 2014. Abbiamo voluto validare le caratteristiche di stabilità anti-ribaltamento e verificare la possibilità di opposizione passiva ad una alzata non controllata e il fatto che Iremia inibisce la possibilità di protendersi in avanti con il rischio di caduta.

**COLORI**  
 Sono disponibili le seguenti combinazioni colori:



**LE NOSTRE VALIDAZIONI/SPERIMENTAZIONI**

Attualmente la poltrona è in sperimentazione presso l'associazione Alzheimer di Bari e presso la Fondazione Tusculum di Arogno (Svizzera). A breve renderemo pubblici sul nostro sito i risultati definitivi. Ci preme specificare che la poltrona Iremia non è un sistema di contenzione, rappresenta bensì una poltrona utilizzabile, grazie alle sue caratteristiche specifiche, sia in struttura che presso il domicilio.

**GENERALI ARREDAMENTI s.r.l.**  
 Via Pisa, 8 - loc. Bonelle  
 51100 Pistoia  
 Tel. 0573 986208  
 Fax. 0573 985427  
 www.generaliarredamenti.it  
 info@generaliarredamenti.it

La poltrona contenitiva a noi fornita in prova dalla Ditta "Generali Arredamenti" di Pistoia è stata provata per circa un mese su un campione di 6 persone che normalmente sono posizionati in poltrona o in carrozzina, 5 dei quali con cintura di contenzione.

**Analisi dei risultati:**

su 6 persone, 3 hanno fatto un tentativo di alzarsi arrivando fino a bordo poltrona senza però riuscire a raggiungere la posizione eretta.

Le altre 3 persone non hanno nemmeno provato, si sono sentite a loro agio.

Le persone che hanno fatto il tentativo sono persone con caratteristiche da Wondering o con agitazione psicomotoria.


Le persone che hanno accettato senza problemi hanno come caratteristica la goffaggine o sono comunque persone tranquille con le quali si è intervenuti con la contenzione per evitare scivolamenti dalla seduta.

In conclusione si può considerare che comunque nessuno è riuscito ad alzarsi senza l'aiuto dell'operatore.

La Coordinatrice di Struttura



**GENERALI ARREDAMENTI**

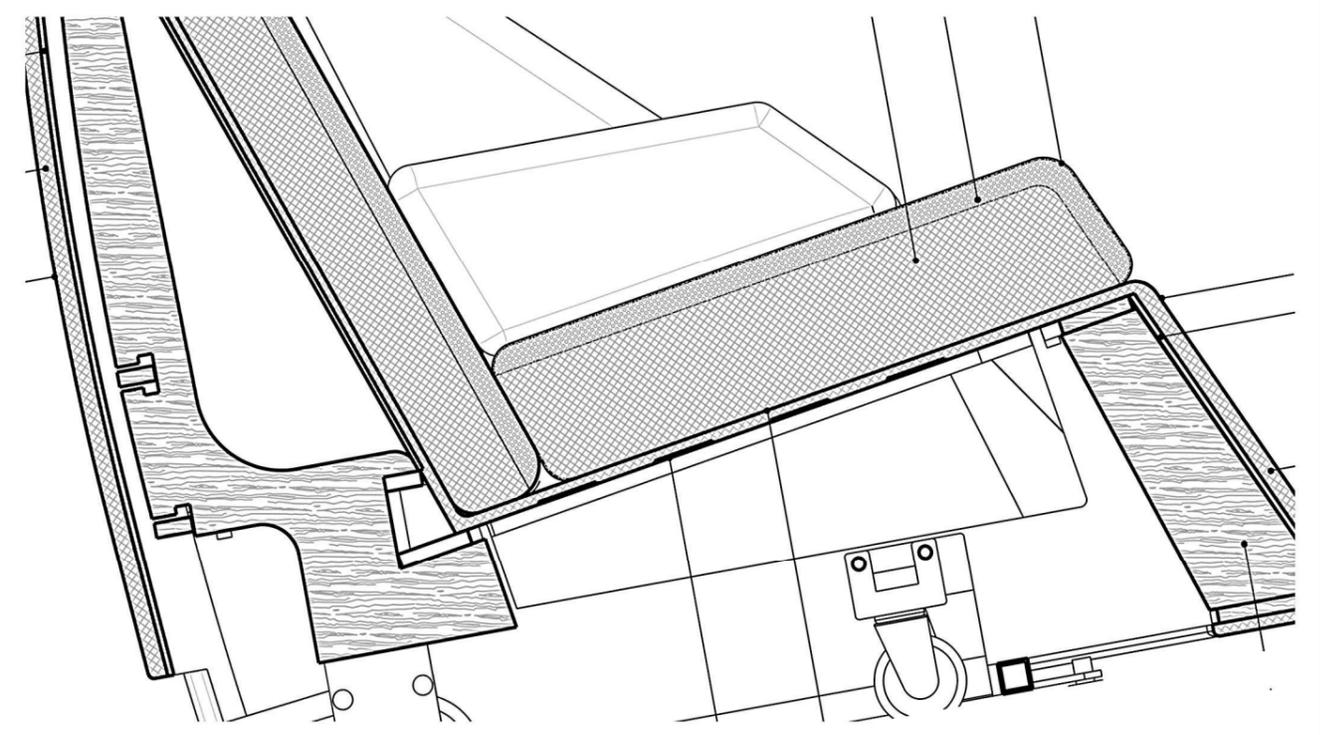

**IREMIA GENERALI ARREDAMENTI**

LA POLTRONA ERGONOMICA STUDIATA PER L'ALZHEIMER



## DA COSA NASCE L'ESIGENZA DI UNA SEDUTA PER L'ALZHEIMER


La creazione di una seduta appositamente concepita per l'utente con Alzheimer nasce dalle reali esigenze, percepite sia in struttura, che nell'ambito domiciliare, di avere una seduta stabile, comoda, morbida ed avvolgente, di dimensioni contenute e adatte agli spazi di una residenza moderna, che sappia accompagnare l'utente nei momenti di agitazione con la sua particolare conformazione ergonomica ed antropometrica, contrastando il naturale sbilanciamento in avanti - con conseguente pericolo di caduta - dell'anziano.



## I CARATTERI ANTROPOMETRICI



(In posizione assisa entro il range della variabilità umana)

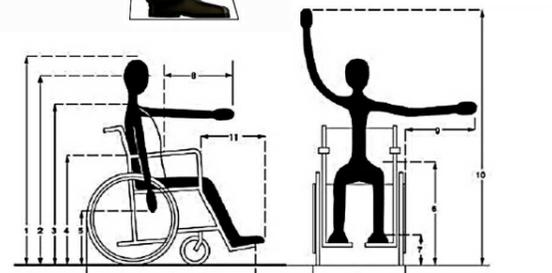

PARAMETRI	uomini			donne		
	5°	50°	95°	5°	50°	95°
1. altezza del capo	1260	1335	1410	1180	1265	1355
2. altezza degli occhi	1150	1220	1290	1080	1160	1235
3. Altezza delle spalle	965	1090	1100	910	985	1065
4. altezza del gomito	625	685	745	610	670	730
5. altezza della mano (alla nocca)	370	435	500	330	405	480
6. altezza delle gambe	620	650	680	565	600	635
7. altezza dei piedi	120	150	180	165	190	215
8. presa frontale della mano (dall'addome)	370	455	540	330	410	490
9. presa laterale della mano (dalla ruota)	580	645	710	520	580	640
10. presa verticale della mano	1550	1665	1785	1460	1570	1680
11. dist. dalla estremità dei piedi al bracciolo	360	435	505	305	370	435
<b>dimensioni della sedia a ruote:</b>						
	min		media		max	
12. lunghezza complessiva della sedia	915		1075		1445	
13. larghezza complessiva della sedia	560		615		645	

## LA REALIZZAZIONE: LA POLTRONA IREMIA


Dispositivo pensato per intervenire su pazienti con particolari stati di agitazione; la seduta è avvolgente e il movimento in avanti è naturalmente inibito grazie alla sua particolare conformazione anatomica e geometrica. Omologata in classe 1IM, ergonomica e realizzata con struttura portante in multistrato di legno, parte superiore di seduta composta da cinghie elastiche. Imbottitura in poliuretano espanso rivestito con resinato ed ecopelle lavabile e impermeabile. Poggiatesta superiore di forma sostenitiva regolabile in altezza; base su ruote, completa di pedale per estrazione.

Maniglia posteriore di spinta in metallo.

Dimensioni: L 839 x H 442/990 x P 1000 mm.

Possibilità di personalizzazione colori di rivestimento.

Qui sotto vds. dettaglio del tessuto e delle cuciture.

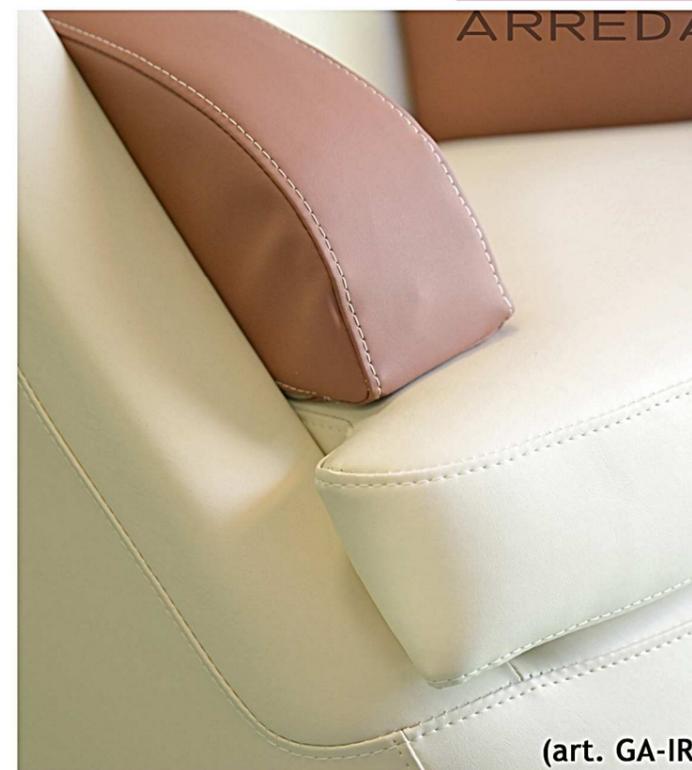

(art. GA-IR)